




IG-30

VAL0122851 / SKC9069808

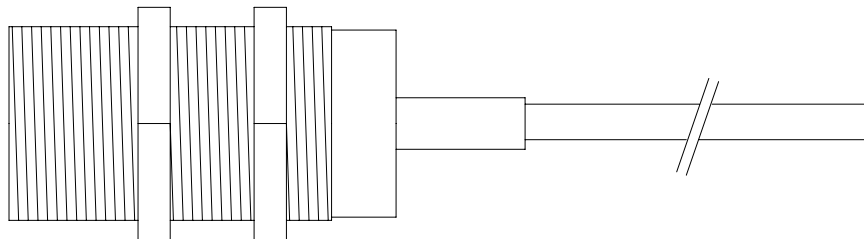


ИНДУКТИВНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

ДЛЯ МОНИТОРА SAFESET
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



СОДЕРЖАНИЕ

1. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ
2. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
3. ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ
4. СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЙ

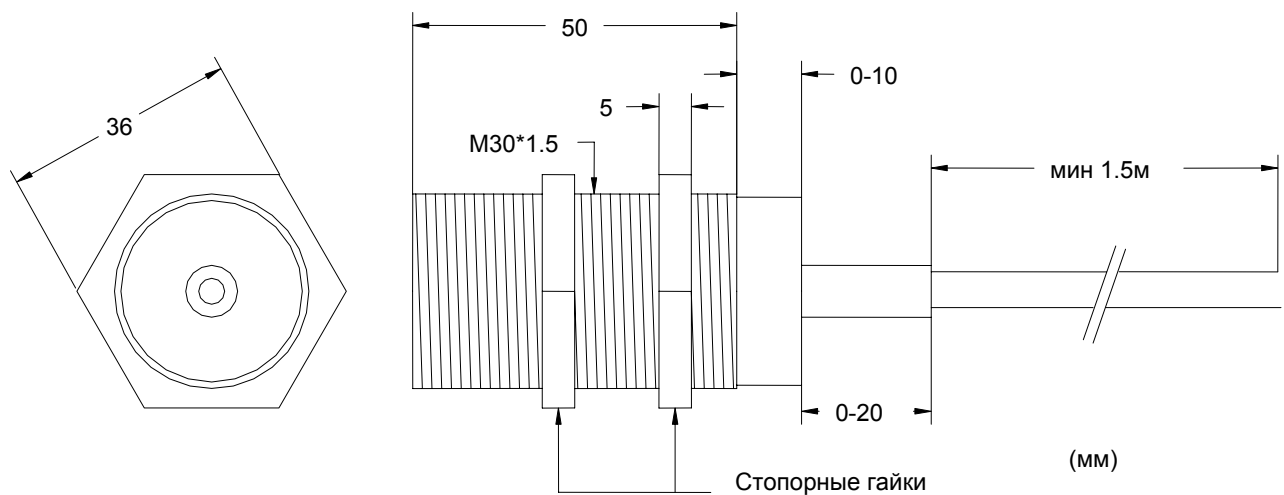1. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ**2. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**


Изделие №: IG-30 / VAL0122851 / SKC9069808
Длина измерения: 10 мм
Соединитель: 3-проводный кабель. Подсоединить к коробке KB-01.
Вес: 0.1 кг

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

3.1 ИНДЕКС


Установить индексный держатель на одном из винтов вала.

Держатель должен быть как минимум 100 * 50 мм, минимум 5 мм толщиной и изготовлен из магнитной стали.

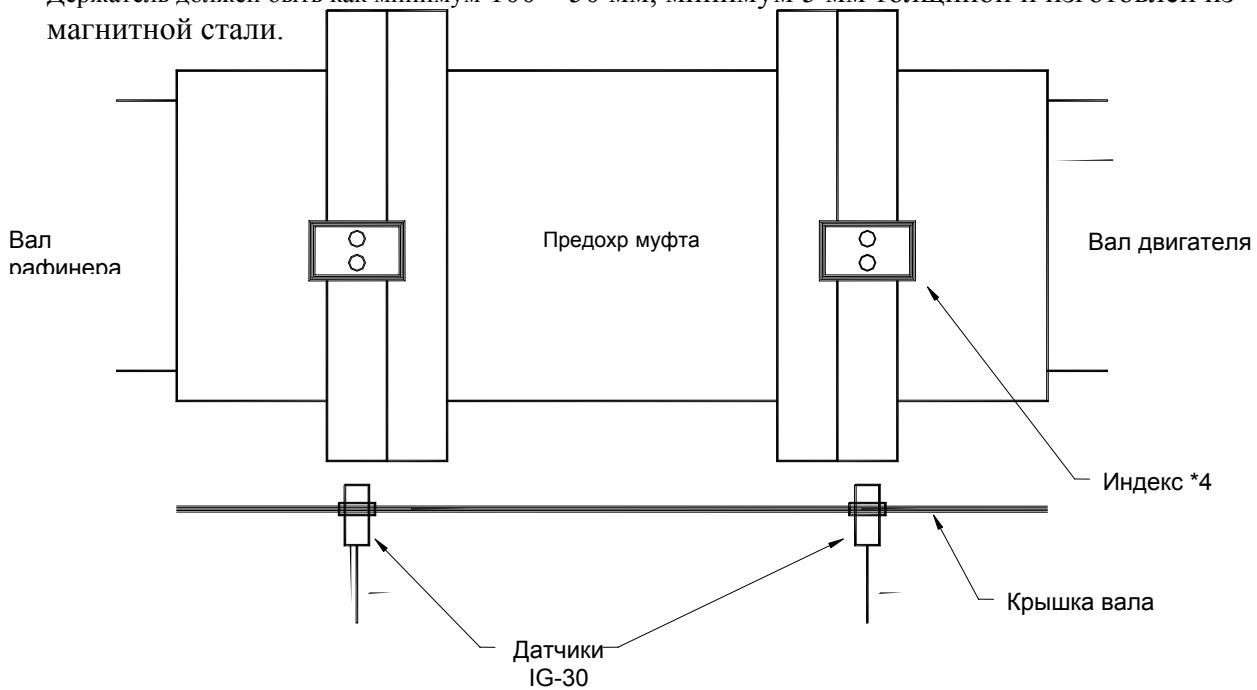

3.2 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Смонтировать преобразователь на нижней крышке вала, указанном на индексе. Учет средней точки допустимого осевого перемещения вала должен быть произведен до определения осевого положения датчиков. Отрегулировать радиальное расстояние до 5 ± 1 мм.

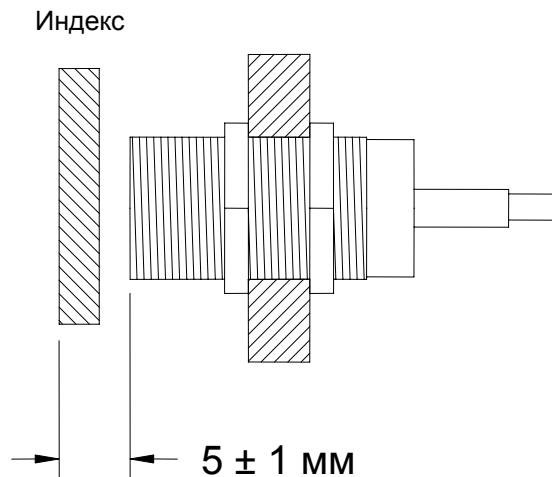

4. СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

